

Общество с ограниченной ответственностью "ЗАОТЭК"


Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 664009, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Инподромная, дом 176;

Фактический адрес: 664007, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, д.29, пом. №32

Телефон: +7(3952)43-50-60, e-mail: Appalab2020@mail.ru

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.210B27	Дата получения 02.11.2020
---	------------------------------

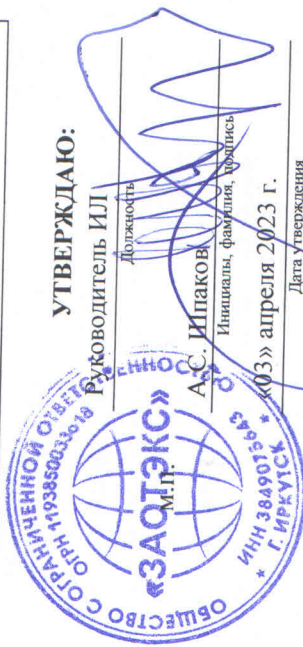

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

№ 952/SOУТ- ВЛ
(идентификационный номер)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Максимовский карьер 2010"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 664035, г.Иркутск, проезд Удинский, 18; Иркутская обл., с.Мамоны

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Срок действия	Погрешность СИ и диапазоны значений измерений	Рабочие условия эксплуатации СИ
МЕТЕОСКОП-М термометр, гигрометр, анемометр и барометр	438720	С-БП/17-02-2022/132846950	17.02.2022-16.02.2024	Погрешность: $\pm 0,2$ °C; $\pm 3,0\%$; от 0,1 до 1 м/с: $\pm (0,05 + 0,05V)$ От 1 до 20 - $\pm (0,1 + 0,05V)$ м/с, где V – значение измеряемой скорости. Диапазоны: Температура (-40...+85) °C Давление воздуха (80-110) кПа Влажность (3-97) %	t: (от -20 до +55)°C; v: до 97% при 25 °C

Сводный протокол № 952/SOУТ- ВЛ

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя лаборатории. Представленные результаты относятся только к объектам, прошедшим испытание. Лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком

Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	БФ211230	С-БП/12-04- 2022/148356082	12.04.2022- 11.04.2023	$\pm 0,2$ дБ; $\pm 0,2$ дБ; $\pm 0,3$ дБ; $\pm 0,3$ дБ; 0,3 дБ/ Диапазоны измерений: Уровень звука (32-149) дБ; Вибрация общая (64-164)дБ; Вибрация локальная (64-164)дБ	Температура воздуха: (от -10 до +50)°С; Относительная влажность: до 90% при 25 °С; Атмосферное давление (86-108) кПа
Виброкалибратор многочастотный ВК 16/160	013621	С-БП/30-06- 2022/167159684	30.06.2022- 29.06.2023	Погрешность: $\pm 0,5\%$ Частота воспроизводимых колебаний: 159,92 Гц 15,92 Гц	температура от -10 °С до +50 °С, относительная влажность от 10 % до 90 % (без конденсации).

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений:

- МИ ПКФ-15-018 Методика измерений локальной вибрации, передающейся на руки водителей автомобильных транспортных средств через руль.
- МИ ПКФ-15-022. Методика измерений локальной вибрации ручной машины в условиях эксплуатации на рабочем месте.

4. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения оцениваемого фактор:

- «Методика проведения специальной оценки условий труда. Приложение N1» (Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 33н от 24 января 2014 г.).

5. Сведения об условиях проведения измерений:

Место проведения измерений	Температура воздуха, °С	Относительная влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
административное помещение	23	40	725
участок работ	20	45	725
участок работ	19	53	725

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров локальной вибрации:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Источник вибрации	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	U(LEX,8h)*, дБА	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время, мин
г. Иркутск пер. 1-й Советский 1								
Теплоэнергетический цех								
21	Слесарь-сантехник (5 разряда)	ручной электронинструмент	22.02.2023				2	
	Участок работ							96
	Корректированный уровень (ось X)			122.6		126		
	Корректированный уровень (ось Y)			121.2		126		
	Корректированный уровень (ось Z)			122.0		126		
	Эквивалентный корректированный уровень:							
	Ось X			116	3.6	126	2	
	Ось Y			114	3.6	126	2	
	Ось Z			115	3.6	126	2	


7. Дополнения отклонения или исключения из метода измерений: отсутствуют

8. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

3731 _____
(№ в реестре экспертов) Инженер лаборатории _____
(подпись)

Алексеева Ирина Николаевна
(Ф.И.О.)

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

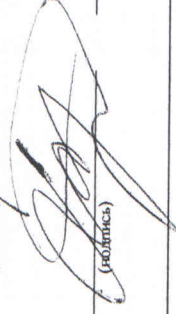_____ 
(№ в реестре экспертов) Инженер лаборатории _____
(подпись)

Бортник Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

конец протокола